

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do podaży leków.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### Zestaw pytań nr 1:

##### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w części 14 Zamawiający oczekuje, aby koreczki dezynfekcyjne posiadały wyprofilowany ergonomiczny uchwyt o wysokości min. 2 cm pozwalający na pewne i stabilne zamocowanie koreczka na zaworze bezigłowym.


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki dezynfekcyjne posiadające wyprofilowany ergonomiczny uchwyt o wysokości min. 2 cm pozwalający na pewne i stabilne zamocowanie koreczka na zaworze bezigłowym.**

#### Zestaw pytań nr 2:

##### Pytanie nr 1

Pytanie do pakietu 23

Czy Zamawiający dopuści produkt konkurencyjny- port w całości wykonany z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon) z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z Komorą zapobiegającą powstawaniu skrzepin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru ( ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu), 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm, średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa, igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g, igła wprowadzająca 18 G, rozrywalna koszulka, prowadnica



Możliwość podawania kontrastu PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w celu łatwiejszej lokalizacji  
Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć,

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

· Pacjent z portem może być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 - Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m)

· W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

· Sterylna osłona głowicy z samoprzylepną powierzchnią z żelem 15 g.18x120. Klej eliminuje potrzebę stosowania żelu pod osłonę – eliminuje tworzenie pęcherzyków. Teleskopowe składanie zapewnia sterylną aplikację. Dzięki minimalnej ilości produktów w zestawie przyspiesza i ułatwia pracę personelowi medycznemu. Zalety: brak gumek, brak żelu w głowicy, brak pozostałości kleju, bez lateksu

Dla pozycji 1- 6F

Dla pozycji 2- 6F i 8F

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 2

Pytanie do pakietu 24 Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem o dł. 18cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknień ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP.

Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25, 32, 38mm



**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Zestaw pytań nr 3:

##### Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień,

2) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień,

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Zestaw pytań nr 4:

##### Pytanie nr 1

Pakiet nr 23

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści port naczyniowy z w rozmiarze DxSxW – 31,0x22,2x12,2mm i wadze 7,6 g

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



**Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza port naczyniowy z w rozmiarze DxSxW – 31,0x22,2x12,2mm i wadze 7,6 g:**

**Pytanie nr 2**

w pozycji 2 port naczyniowy w rozmiarze DxSxW - 25,8x20,8x10,1mm i wadze 5,0g, objętość wewnętrzna 0,35ml spełniając pozostałe parametry?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza port naczyniowy w rozmiarze DxSxW - 25,8x20,8x10,1mm i wadze 5,0g, objętość wewnętrzna 0,35ml spełniając pozostałe parametry.**

**Zestaw pytań nr 5:**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 1 poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawki insulinowej z igłą 0,4x13mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki insulinowe z igłą 0,4x13mm.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 4 poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie sterylne przyrządy do przetaczania płynów oraz krwi, których komora kroplowa wykonana jest z bezpiecznego medycznego PCV.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylne przyrządy do przetaczania płynów oraz krwi, których komora kroplowa wykonana jest z bezpiecznego medycznego PCV.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 7 poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie worków do ochrony przed światłem w kolorze żółtym. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 7 poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga badań potwierdzających w zakresie sprawdzenia przepuszczalności światła UV?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet nr 8 poz. b-d

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer Lock ze skalą rozszerzoną 10-12ml, 20-22ml, 30-33ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki Luer Lock ze skalą rozszerzoną 10-12ml, 20-22ml, 30-33ml.**

**Pytanie nr 6**

Pakiet nr 8 poz. a

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer Lock w opakowaniach po 100szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki Luer Lock w opakowaniach po 100szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet nr 8 poz. c

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer Lock w opakowaniach po 50szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki Luer Lock w opakowaniach po 50szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet nr 8 poz. d

Proszę o dopuszczenie strzykawek Luer Lock w opakowaniach po 16szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki Luer Lock w opakowaniach po 16szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet nr 9 poz. c

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z końcówką Luer 10ml ze skalą 0,2ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowych z końcówką Luer 10ml ze skalą 0,2ml.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet nr 9 poz. d

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z końcówką Luer 20ml w opakowaniach po 50 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowych z końcówką Luer 20ml w opakowaniach po 50 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet nr 12 poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawek. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawki

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet nr 13 poz.2

Czy strzykawka ma posiadać skalę 50 ml na tłoku strzykawki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skalę 50 ml na tłoku strzykawki.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet nr 13 poz.3

Czy Zamawiający miał na myśli kaniulę dożylną typu motylek z igłą 20mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet nr 13 poz.4

Czy Zamawiający miał na myśli koreczki do dezynfekcji w opakowaniu zawierającym 25 pasków po 10 koreczków dezynfekujących, dezynfekcja do 30 sekund, sterylizowane radiacyjnie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki do dezynfekcji w opakowaniu zawierającym 25 pasków po 10 koreczków dezynfekujących, dezynfekcja do 30 sekund, sterylizowane radiacyjnie.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org





**Pytanie nr 15**

Pakiet nr 15, 16

Czy kraniki mają posiadać wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi w celu niepowodowania kontaminacji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kraniki posiadające wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi w celu niepowodowania kontaminacji.**

**Pytanie nr 16**

Pakiet nr 19 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania i przygotowania leków wyposażony w filtr powietrza 0,45 µm oraz filtr cząsteczkowy 5 µm

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 17**

Pakiet nr 19 poz. 1

Proszę o odpuszczenie wymogu w przyrządzie do wielokrotnego pobierania i przygotowania leków skuteczności bakteriologicznej >99,999%, ponieważ wymóg ten wskazuje na jednego producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przyrząd był kompatybilny z aktualnie zamawianymi przez Zamawiającego butelkami KabiPack i KabiClear.**

**Pytanie nr 18**

Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji.**

**Pytanie nr 19**

Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardego blistera, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczki w opakowaniu twardego blistera, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 21 poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie kaniuli, których cewnik wykonany jest z PTFE.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 21**

Pakiet nr 21 poz. 1,2,3

Proszę o dopuszczenie kaniuli, których nazwa producenta jest na opakowaniu jednostkowym kaniuli.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 22**

Pakiet nr 21 poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie kaniuli w następujących rozmiarach 14G dł. 45mm, 16G dł.45mm oraz 20G w jednym rozmiarze 33mm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

**Pytanie nr 23**

Pakiet nr 21 poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznych w następujących rozmiarach: 14G dł.45mm, 16G dł.45mm, 18G dł.32mm oraz 45, 20G dł.25mm i 32mm.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 24**

Pakiet nr 21 poz. 4

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego o przepływie 320ml/h

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 25**

Pakiet nr 21 poz. 4

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego o objętości wypełnienia 0,085 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 26**

Pakiet nr 21 poz. 4

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego w opakowaniach po 250szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawór bezigłowy w opakowaniach po 250szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.**

**Pytanie nr 27**

Pakiet nr 21 poz. 8

Proszę o dopuszczenie aparatu z precyzyjnym regulatorem przepływu z komorą kroplową z bezpiecznego, medycznego PCV.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 28**

Pakiet nr 21 poz. 8

Proszę o dopuszczenie aparatu z precyzyjnym regulatorem przepływu z kontrolą przepływu 0-250ml/h

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 29**

Pakiet nr 21 poz. 8

Proszę o dopuszczenie aparatu z precyzyjnym regulatorem przepływu z kontrolą przepływu 0-300ml/h

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 30**

Pakiet nr 21 poz. 8

Proszę o dopuszczenie aparatu z precyzyjnym regulatorem przepływu z nazwą firmy na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



**Pytanie nr 31**

Pakiet nr 21 poz. 8-9

Proszę o odpuszczenie wymogu w aparacie z precyzyjnym regulatorem przepływu o filtracji bakterii min. 99,99% ponieważ wymóg ten wskazuje na jednego producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 32**

Pakiet nr 21 poz. 9

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń z filtrem powietrza o skuteczności potwierdzonej badaniami min. 96%

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 33**

Pakiet nr 21 poz. 9

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń z drenem 180cm

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Zestaw pytań nr 6:**

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 3 strzykawkę insulinową z igłą nałożoną 0,4x12 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 3 strzykawkę insulinową z igłą nałożoną 0,33x13 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 poz. 3 strzykawkę insulinową z igłą nałożoną 0,33x13 mm.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 1 c igły do pobierania leków 1,2x40 18G z otworem bocznym bez filtra cząsteczkowego 5 µm ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany. Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza igły posiadające filtr cząsteczkowy, ale ich nie wymaga.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 1 przyrząd do przetaczania płynów typ IS z długą, elastyczną komorą kropłową ze znacznikiem płynu o długości min. 62 mm, nie zawierający ftalanów i lateksu, igła biorcza ścięta czteropłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik-hydrofobowy filtr powietrza, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, dren o długości 180cm, posiada precyzyjny regulator przepływu płynu z zaczepem do umocowania końcówki drenu podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, dren zakończony nasadką z filtrem hydrofobowym uniemożliwiającym wykapanie płynu w czasie wypełniania drenu, sterylizowany EO, opaska stabilizująca przyrząd szerokość min. 60mm, opakowanie przyrządu blister - pack. Brak ftalanów i lateksu potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 3 przyrząd z komora kroplową która nie jest wolna od PVC , brak nazwy producenta na przyrządzie (jest na opakowaniu) , brak filtra powietrza , igła jednokanałowa ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 poz. 1 d zaoferowanie strzykawkę 20 ml w opakowaniach x 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1360 op ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15 poz. 1 zaoferowanie kraników trójdrożnych z objętością ~0,26 ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 15 poz. 1 zaoferowanie kraników trójdrożnych z objętością ~0,26 ml ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 poz. 1 zaoferowanie bezigłowego port do zabezpieczenia dostępu naczyńwowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer – Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,085 ml, przepływ 312 ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania do 7 dni lub 600 aktywacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 poz. 2 zaoferowanie kaniuli wykonanej z FEP 14G 2,1mmx45 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 19 poz. 1 zaoferowanie przyrządu do wielokrotnego pobierania i przygotowania leków z filtrem powietrza 0,1 µm i filtrem płynów 5 µm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przyrząd był kompatybilny z aktualnie zamawianymi przez Zamawiającego butelkami KabiPack i KabiClear.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 21

Czy Zamawiający w pakiecie nr. 21 dopuści zaoferowanie poz. 1 kaniul do krótkotrwałych wkłuc dożylnych z portem umiejscowionym nie centralnie nad skrzydełkami (nieco wychodzi poza ich obrys), z koreczkiem zabezpieczonym (gwintem) przed przypadkowym otwarciem, min. 3 paski RTG radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę cewnika kaniuli, cewnik PUR, opakowanie pojedyncze odporne na przypadkowe uszkodzenia, kaniule muszą posiadać na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym oznaczenie prędkości przepływu ml/min., rozmiar:

14G (2,1x45mm) przepływ 305ml/min.;

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org





16G (1,7x45mm) przepływ 200ml/min.;  
17G (1,5x45mm) przepływ 142ml/min.;  
18G (1,3x32mm) przepływ 90ml/min.;  
18G (1,3x45mm) przepływ 90ml/min.;  
20G (1,1x32mm) przepływ min. 56ml/min.;  
20G (1,1x25mm) przepływ min. 56ml/min.;  
22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.;  
24G (0,7x19mm) przepływ 23ml/min.?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści zaoferowanie poz. 3 kaniuli do wlewów dożylnych typu bezpiecznego z portem bocznym, który wychodzi nieco poza obrys skrzydełek, cewnik wykończony z PUR, samodomykający korek portu górnego, komora wypływu w porcie głównym wyposażona filtr hydrofobowy ułatwiający wizualizację prawidłowości wkłucia, cewnik widoczny w RTG 6 pasków radiocieniujących, automatycznie aktywne zabezpieczenie igły w postaci plastikowego/metalowego zatrzaśku zabezpieczającego przed zakłuciem, nazwa producenta kaniuli umieszczona bezpośrednio na kaniuli, rozmiar:

14G (2,1x45mm) przepływ 305ml/min.;  
16G (1,7x45mm) przepływ 200ml/min.;  
17G (1,5x45mm) przepływ 142ml/min.;  
18G (1,3x32mm) przepływ 105ml/min.;  
18G (1,3x45mm) przepływ 100ml/min.;  
20G (1,1x32mm) przepływ 61ml/min.;  
20G (1,1x25mm) przepływ 65ml/min.;  
22G (0,9x25mm) przepływ 36ml/min.;  
24G (0,7x19mm) przepływ 23ml/min. ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 21 dopuści zaoferowanie poz. 2 kaniuli do krótkotrwałych wkłuć dożylnych z portem (nieco poza obrysem skrzydełek), ze skrzydełkami, zastawką, min. 2 paski RTG radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę cewnika kaniuli, cewnik FEP, nazwa producenta na opakowaniu, opakowanie pojedyncze odporne na przypadkowe uszkodzenia, kaniule muszą posiadać na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym oznaczenie prędkości przepływu ml/min., rozmiar:

14G (2,1x45mm) przepływ 305ml/min.;  
16G (1,7x45mm) przepływ 200ml/min.;  
17G (1,5x45mm) przepływ 142ml/min.;  
18G (1,3x45mm) przepływ 90ml/min.;  
18G (1,3x32mm) przepływ 90ml/min.;  
20G (1,1x32mm) przepływ 61 ml/min.;  
20G (1,1x25mm) przepływ 65 ml/min.;  
22G (0,9x25mm) przepływ 36 ml/min.;  
24G (0,7x19mm) przepływ 23 ml/min.?

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 poz. 4 zaoferowanie bezigłowego port do zabezpieczenia dostępu naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer – Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,085 ml, przepływ 312 ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania do 7 dni lub 600 aktywacji ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

#### Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 poz. 8 zaoferowanie aparatu do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji z zaworem bezzwrotnym – przezroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99%, przeciwbakteryjnym, samozamykającym się korkiem, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy w nasadce na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, zawór bezzwrotny na końcu drenu uniemożliwiający cofanie się krwi do drenu, dren o długości min. 180 cm, opaska stabilizująca. Nie zawiera lateksu i ftalanów, niepirogenny. Opakowanie papier-folia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 poz. 9 zaoferowanie aparatu do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji z portem bezigłowym – przezroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99%, przeciwbakteryjnym, samozamykającym się korkiem, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy 15 µm na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu. Dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem bezigłowym w odległości ok. 30 cm od zakończenia drenu do podawania leków. Opaska stabilizująca zabezpiecza aparat przed przypadkowym zainfekowaniem. Aparat nie zawiera lateksu i ftalanów i jest niepirogenny. Opakowanie papier-folia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

### Zestaw pytań nr 7:

#### Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy, „Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania działu, z zastrzeżeniem wskazania numeru telefonu i adresu mailowego do kontaktu.**

#### Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 5 pkt 1) „Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy: 1) Wykonawca jest w zwłoce z dostawą lub reklamacją więcej niż 72 godziny” Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu na: „Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:

1) Wykonawca jest w zwłoce z dostawą lub reklamacją więcej niż 72 godziny i nie zareaguje na wezwanie

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

Zamawiającego do należytego wykonania umowy”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy , § 2 Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 1 ust. 6, Etykiety oraz ulotki informacyjne dołączone do wyrobów winny być sporządzone w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski” Prosimy Zamawiającego o uznanie powyższego wymogu za spełniony, (dotyczy pakietu nr.24) jeśli: Etykiety (oznaczenia fabryczne) zastosowane przez producenta posiadają jednoznaczny i niebudzący wątpliwość rysunek wężyków oraz nr katalogowy wyrobu medycznego, który umożliwi identyfikację produktu. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, dopuszcza się dla wyrobów przeznaczonych do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczanych profesjonalnym użytkownikom (nie pacjentom) oznakowania lub instrukcje obsługi w języku angielskim.

Ponadto etykiety (oznaczenia fabryczne) zastosowane przez producenta posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków. Poza tym dostarczane są do profesjonalnego użytkownika, jakim jest personel medyczny szpitala. Wężyki pompy oraz pacjenta posiadają opis w postaci symboli oraz prostych zwrotów w języku angielskim tłumaczących te symbole a w każdym opakowaniu zbiorczym znajduje się instrukcja obsługi w języku polskim. Rozporządzenie MDR mówi: art. 12.4 Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 4 ust. 1 punkt 1) i 2) „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych: za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień, za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień” W naszej opinii zaproponowana kara umowna 2% jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona około 0,2 – 1% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o obniżenie kary umownej do poziomu 1%.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy , § 4 Prosimy o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

#### Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 4, ust. 3 Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy , § 2 ust. 2 „Dostawy będą się odbywać sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych (trzech dni roboczych dla zamówienia paletowego) od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, pisemnie lub e-mailem. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówień do 3 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy , § 2 ust. 2 „Dostawy będą się odbywać sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, pisemnie lub emailem” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie.

W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Zestaw pytań nr 8:

##### Pytanie nr 1

Pakiet 2

Pakiet 2 pozycja 1 a. i b.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 2 pozycja 1 a. i 1 b. alternatywnych kodów i rozmiarów igieł iniekcyjnych w związku z uproszeniem katalogu igieł ■. Mniejsza ilość kodów pozwala ograniczyć stany magazynowe i koszty a ponieważ igły są cienkościenne stwierdzamy, że igła cienkościenna ■ umożliwi zastosowanie igły o mniejszym rozmiarze, ponieważ szybkość przepływu jest taka jak w igle ■ o standardowych ściankach, większej o jeden rozmiar. (LIST W ZAŁĄCZENIU)

Ad 1a.

\*rozmiar 0,7 x 40mm prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,6 x 40mm

\*rozmiar 0,9 x 40mm prosimy o dopuszczenie rozmiaru 0,8 x 40mm

Ad 1b.

\*rozmiar 1,8 x 40mm prosimy o dopuszczenie rozmiaru 1,6 x 40mm

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 2

Pakiet 2 pozycja c

Prosimy o dopuszczenie igły tępej do pobierania leków ściętej pod kątem 40° pozwala ograniczyć ryzyko wycięcia fragmentu korka w rozmiarze 1,2 x 40 18G x100szt?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 3

Pakiet 3

Pakiet 3 poz 1 Czy igła do pobierania leków z filtrem, powinna posiadać przezroczystą poliwęglanową nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym - wyraźnie widocznym, w celu łatwego rozróżnienia tępej igły do pobrania z

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org





filtrem . Nasadka nie krótsza niż 2,5 cm dla łatwego pobrania całości leku ze szklanej fiołki, jałowa - sterylizowana R. Osłona czerwona. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem fioletowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.**

#### Pytanie nr 4

Pakiet 4

Pakiet 4 pozycja 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do infuzji grawitacyjnej o następujących cechach: komora kroplowa o długości 57mm oraz dren wykonane z PCV bez DEHP, igła czterokanalowa/ stożek z odpowietrzeniem, zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenia końca po użyciu, objętość wypełnienia 11ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.**

#### Pytanie nr 5

Pakiet 4 pozycja 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do infuzji grawitacyjnej bursztynowy o następujących cechach: komora kroplowa o długości 60mm oraz dren wykonane z PCV bez DEHP, igła czterokanalowa/ stożek z odpowietrzeniem, zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenia końca po użyciu, objętość wypełnienia 12ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.**

#### Pytanie nr 6

Pakiet 4 pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do transfuzji krwi o następujących cechach: komora kroplowa o długości min 90mm oraz dren wykonane z PCV bez DEHP, igła ścięta jednostronnie/lancet, czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), objętość wypełnienia 14ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.**

#### Pytanie nr 7

Pakiet 4 pozycje 1,2,3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuję aparatów pakowanych w opakowanie papier/folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparaty pakowane w opakowanie papier/folia.**

#### Pytanie nr 8

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego w pak. 8, poz. d o dopuszczenie opakowania po 60 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania po 60 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

#### Pytanie nr 9

Pakiet 8 pozycje a, b, c, d

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pak 8 oczekuje strzykawek od 1 producenta, dla zagwarantowania stałej jakości dla wszystkich pozycji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający w powyższej pozycji wymaga strzykawek od jednego producenta.**

#### Pytanie nr 10

Pakiet 8 pozycje a, b, c, d

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



Prosimy o doprecyzowanie czy wewnętrzna powierzchnia strzykawki powinna być natłuszczona olejem silikonowym (dla eliminacji zacinań się, sztucznego wzrostu ciśnienia okluzji i wywoływania alarmów pompy) o zawartości poniżej 0,25 mg/cm<sup>2</sup> co zapewnia niski opór tłoka strzykawki, potwierdzony dokumentem producenta dołączonym do oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki natłuszczone olejem silikonowym o zawartości poniżej 0,25 mg/cm<sup>2</sup>.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 9

Pakiet 9 pozycje 1,2,3,4,

Czy Zamawiający oczekuje aby strzykawki były oznaczone na opakowaniu jednostkowym numerem serii i datą ważności oraz na opakowaniu zbiorczym kolorystyczne oznakowanie w zależności od rozmiaru co pozwala na szybką identyfikację produktu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby strzykawki były oznaczone na opakowaniu jednostkowym numerem serii i datą ważności oraz dopuszcza znakowanie kolorystyczne.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet 9 pozycje 1,2,3,4,

Czy Zamawiający oczekuje aby strzykawki posiadały cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki posiadające cylinder wykonany z polipropylenu, tłok wykonany z polietylenu.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet 9 pozycje 1,2,3,4,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z mlecznym/białym tłokiem nieprzeźroczystym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki z mlecznym/białym tłokiem nieprzeźroczystym.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet 11

Pakiet 11 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 11 „Strzykawka do przepłukiwania dostępu naczyniowego, fabrycznie napełnione izotonicznym roztworem 0,9% NaCl” mają posiadać nośnik niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wyrobu (UDI) na cylindrze, co umożliwi jednoznaczną identyfikację każdego wyrobu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty minimum 3 badań klinicznych wykazujących redukcję odcewnikowych zakażeń krwi (CRBSI) po zastosowaniu oferowanej marki fabrycznie napełnionej strzykawki do przepłukiwania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty minimum 3 badań klinicznych wykazujących redukcję odcewnikowych zakażeń krwi (CRBSI) po zastosowaniu oferowanej marki fabrycznie napełnionej strzykawki do przepłukiwania.**

**Pytanie nr 16**

Prosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego w pakiecie 11 mają posiadać długi ( min 2 cm ) korek zabezpieczający końcówki Luer-Lok™, który umożliwia szczelne zamknięcie zapewniające integralność, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez dotyk?

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.**

**Pytanie nr 17**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkt ma być zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III, zgodnie z regułą 14, załącznik VIII, Rozporządzenia UE MDR 2017/745, która mówi: wszystkie wyroby zawierające jako swoją integralną część substancję, która w przypadku użycia osobno może być uważana za produkt leczniczy w rozumieniu art. 1 pkt 2 dyrektywy 2001/83/WE, w tym produkt leczniczy na bazie ludzkiej krwi lub ludzkiego osocza w rozumieniu art. 1 pkt 10 tej dyrektywy, i której działanie ma charakter pomocniczy w stosunku do działania tych wyrobów, należą do klasy III.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ: „Wyrób zakwalifikowany do klasy IIa lub IIb lub klasy III. „**

**Pytanie nr 18**

5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 11 oczekuje strzykawek w opakowaniu papier/folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 11 strzykawki w opakowaniu papier/folia.**

**Pytanie nr 19**

Pakiet 12

Pakiet 12 pozycje 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w sformułowaniu; „możliwe do wyboru w menu pomp” Zamawiający ma na myśli aby strzykawki w poz 1 i 2 były fabrycznie wkalibrowane w menu pomp, które są na wyposażeniu Zamawiającego i wymienione w instrukcji obsługi producenta?

Zastosowanie strzykawki, która nie jest wkalibrowana w pompę, skutkuje niewłaściwym podaniem leku co może narazić pacjentów na ryzyko błędów lekowych i problemów z prędkością przepływu, potencjalnie prowadząc do poważnych konsekwencji m.in. takich jak: brak stabilności hemodynamicznej.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby strzykawki były wkalibrowane w menu pomp.**

**Pytanie nr 20**

Pakiet 12 pozycje 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje strzykawek w całości wykonanych z polipropylenu (tłok i cylinder z polipropylenu)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki w całości wykonanych z polipropylenu (tłok i cylinder z polipropylenu.**

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 1, 2, wymaga zaoferowania po 1 strzykawce dla każdej z pozycji. Strzykawce, która jest wpisana równocześnie w menu wszystkich wymienionych pomp przez ich producentów. Pozwoli to na wyeliminować omyłki przy dopasowaniu strzykawek z pompą podczas przygotowywania leków.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania po 1 strzykawce dla każdej z pozycji, która jest wpisana równocześnie w menu wszystkich wymienionych pomp przez ich producentów.**

**Pytanie nr 22**

Pakiet 14

Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie 14 poz. 1 Zamawiający oczekuje aby dołączyć do oferty informację na temat badań wykazujących redukcję następujących bakterii in vitro: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata, Candida albicans i Acinetobacter baumannii. Redukcja Acinetobacter baumannii o 99,99%; co wpływa na redukcję zakażeń odcewnikowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty informacji na temat badań wykazujących redukcję następujących bakterii in vitro: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

**Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Andida glabrata, Candida albicans i Acinetobacter baumannii. Redukcja Acinetobacter baumannii o 99,99%; co wpływa na redukcję zakażeń odcewnikowych.**

**Pytanie nr 23**

Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie 14 poz. 1 Zamawiający oczekuje aby koreczek dezynfekcyjny posiadał karbowany i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Korek bez dodatkowej osłony, zgodny z łącznikami bezigłowymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koreczek dezynfekcyjny posiadający karbowany i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Korek bez dodatkowej osłony, zgodny z łącznikami bezigłowymi.**

**Pytanie nr 24**

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz.1 kranika trójdrożnego odpornego na ciśnienie do 3 Ba i o objętości wypełnienia 0,22ml?? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 24**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 poz.1 kranika trójdrożnego o objętości wypełnienia 0,22ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 15 poz.1 kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 0,22ml. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 25**

Pakiet 17

Pakiet 17 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego z neutralnym przemieszczaniem płynu,- kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, o długości całkowitej 2,7cm, zabezpieczony od strony podłączenia do wkłucia koreczkiem

- przeznaczony do użytku z urządzeniami do terapii dożylnych i dotętnicznej
- silikonowa łatwa do dezynfekcji membrana SplitSeptum, w poliwęglanowym konektorze, która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji
- pomarańczowy pierścień uszczelniający działa jako wskaźnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji
- prosty i przezroczysty tor przepływu (przepływ laminarny) umożliwia łatwe przepłukiwanie i kontrolę wzrokową procedury
- dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi nie zawiera lateksu, DEHP, metalu
- odporny na ciśnienie do 325 psi (22bary), kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego
- czas użycia 7 dni lub 600 aktywacji
- wymagany przepływ 140ml/min
- objętość wypełnienia wynosząca 0,05 ml
- pakowany pojedynczo, sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 26**

Pakiet 17 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze różnym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzysajającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymanie zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

Szybkość przepływu w igłach o ściankach standardowych i igłach cienkościennych

Szanowni Państwo,


Firma ■ dokonuje obecnie standaryzacji oferty igieł standardowych i igieł bezpiecznych w rozmiarach gauge od 16 do 25, o ściankach standardowych (RW) i cienkościennych (TW). Igły w rozmiarach 27 gauge i 30 gauge pozostaną w konfiguracji RW. Zastosowanie kliniczne ■ będzie nadal oferować igły w najczęściej używanych rozmiarach oraz te, które są zgodne z najlepszymi praktykami i wytycznymi klinicznymi, takimi jak:

- Wytyczne Amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) i Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)
- The Green Book (UK): Informacje dla pracowników ochrony zdrowia na temat szczepień
- Kanada – Instrukcja doboru igieł
- Irlandia – Ogólne procedury szczepień

Ponadto ■ będzie nadal oferować igły w najczęściej używanych długościach oraz te, które są zgodne z wytycznymi branżowymi.

Szybkość przepływu ■ wyliczyła minimalny obszar przepływu (w oparciu o minimalną dopuszczalną średnicę wewnętrzną określoną w normie ISO 9626:2016(E)) różnych kaniuli w rozmiarze od 20G RW do 30G RW. W oparciu o zasady mechaniki płynów i przy założeniu, że wszystkie inne czynniki (np. długość, ciśnienie itp.) są równoważne, przepływ wzrasta wraz ze średnicą wewnętrzną i odpowiadającą jej powierzchnią przekroju lub "obszarem przepływu". Wykorzystując minimalne dopuszczalne średnice wewnętrzne [zgodnie z ISO 9626: 2016 (E)] do obliczenia obszaru przepływu, porównujemy obszar przepływu różnych kaniuli z kaniulą 30G RW.

Odnosząc się do rysunku 1 i porównując przewody 20G RW z 21G TW (redukcja 4,6%) oraz 22G RW z 23G TW (różnica 10%), widzimy, że wprawdzie istnieją różnice w obszarze przepływu, ale są one niewielkie w porównaniu z ofertą produktów istotnych dla zastosowań klinicznych.

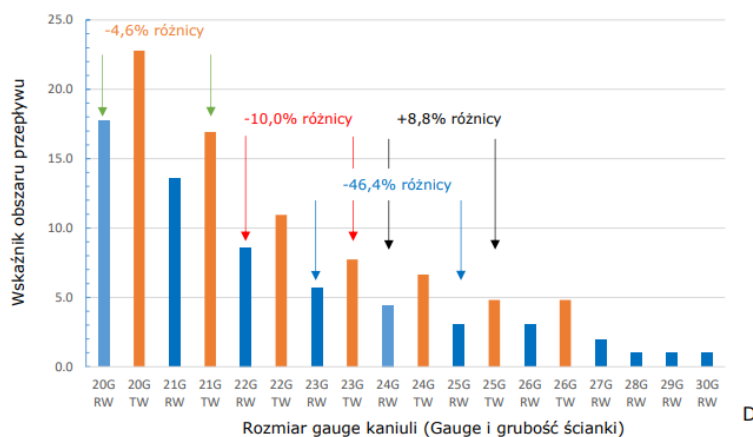

Ryc. 1: Wskaźnik obszaru przepływu dla kaniuli o różnych rozmiarach gauge

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



Aby zapewnić podstawę porównawczą, zmiana obszaru przepływu między 23G RW a 25G RW stanowi redukcję obszaru przepływu o 46,4%. Jak stwierdzono wcześniej w The Green Book (UK): Informacje dla pracowników ochrony zdrowia na temat szczepień, igły 23G do 25G są wskazane do iniekcji domięśniowych.

Ponadto powierzchnia przepływu wzrasta o 8,8% w przypadku przewodów 24G RW w porównaniu z przewodami 25G TW. Na podstawie tych obliczeń i równoważności wszystkich innych czynników (tj. lepkość i ciśnienie płynu), stwierdzamy, że igła cienkościenna umożliwia zastosowanie igły o mniejszym rozmiarze, ponieważ szybkość przepływu jest taka jak w igle o standardowych ściankach, większej o jeden rozmiar.

#### Zestaw pytań nr 9:

##### Pytanie nr 1

Pakiet 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.**

##### Pytanie nr 2

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów.**

##### Pytanie nr 3

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeplu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 4

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 5

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS.**

##### Pytanie nr 6

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania papier-folia.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet 4, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 4, poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet 4, poz. 2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania papier-folia.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet 4, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



**Pytanie nr 14**

Pakiet 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 15**

Pakiet 4, poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 8,5 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 16**

Pakiet 4, poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów.**

**Pytanie nr 17**

Pakiet 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS.**

**Pytanie nr 18**

Pakiet 4, poz. 3

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania papier-folia.**

**Pytanie nr 19**

Pakiet 12, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 20**

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwi przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 21

Pakiet 20

Czy zamawiający wymaga koreczki zwykłe czy kombi?

**Odpowiedź: W pakiecie 20 Zamawiający wymaga koreczków zwykłych. Koreczka Combi Zamawiający wymaga w pakiecie 21. poz. 7.**

#### Zestaw pytań nr 10:

##### Pytanie nr 1

Czy w pakiecie nr 23 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 1: Port naczyniowy z komorą zabezpieczoną tytanowym dnem i obudową wykonaną z Polieteroeteroketon (PEEK). Port w rozmiarze D<sub>x</sub>S<sub>x</sub>W – 33x26x13,7mm i wadze 8 g, objętość wypełnienia 0,5 ml. Średnica membrany 13 mm. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze (6,5Fr) 1,1mm x 2,2 mm o długości 50 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 8Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, przewodnik „J” (0,35” x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowicę USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.**

- Poz. nr 2: Port naczyniowy z komorą zabezpieczoną tytanowym dnem i obudową wykonaną z Polieteroeteroketon (PEEK). Port w rozmiarze D<sub>x</sub>S<sub>x</sub>W – 29x22x11,3 mm i wadze 5 g, objętość wypełnienia 0,3 ml. Średnica membrany 10,8 mm. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze (8,5Fr i 6,5Fr wg. potrzeb Zamawiającego) 11 x 2,2 mm o długości 50 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 8Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, przewodnik „J” (0,35” x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z drenem o długości 25 cm z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowicę USG, dwie sterylne gumki. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu.**

##### Pytanie nr 2

2. Czy w pakiecie nr 24 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Dł. igły: 15,20,22,25,32 mm

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

#### Zestaw pytań nr 11:

##### Pytanie nr 1

Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera z mechanizmem zabezpieczającym przed wkluciem nie posiadającym akustycznej sygnalizacji bezpiecznej pozycji igły?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 2

Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera nie posiadającą poduszki od strony skóry pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 3

Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera z przedłużeniem wykonanym z TPU, bez PCV, DEHP i lateksu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 4

Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera bez możliwości stosowania igły w polu magnetycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 5

Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15mm, 19mm, 25mm, 38mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 6

Pakiet nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera pakowana zbiorczo po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera pakowana zbiorczo po 20 sztuk z przeliczeniem ilości.**

#### Zestaw pytań nr 12:

##### Pytanie nr 1

pakiet nr 19

Czy zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania leków wyposażony w filtr bakteryjny 0,2 µm o skuteczności równej lub wyższej niż 99,99% i filtr cząsteczkowy 5 µm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach opisanych w powyższym pytaniu. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przyrząd był kompatybilny z aktualnie zamawianymi przez Zamawiającego butelkami KabiPack i KabiClear.**

#### Zestaw pytań nr 13:

##### Pytanie nr 1

Pakiet 1

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,45x13mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 2

Pakiet 1

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,4x13mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki z igłą 0,4x13mm.**

##### Pytanie nr 3

Pakiet 2, pozycja 1a-b

Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowe o typie szlifowania LB/BL standard długo ścięte?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 4

Pakiet 2

Pozycja 1c Czy Zamawiający dopuści tępe igły 1,2x40 bez otworu bocznego, ścięte pod kątem 40st., bez filtra?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 5

Pakiet 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do infuzji z komorą o długości całkowitej 60mm (55mm w części przezroczystej)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 6

Pakiet 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy z komorą wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów.**

##### Pytanie nr 7

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek do pomp?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 8

Pakiet 8, pozycja 1a

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

##### Pytanie nr 9

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



Pakiet 8, pozycja 1c

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet 8, pozycja 1c

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,5ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawkę skalowaną co 0,5ml.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczym zabezpieczeniem?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet 9, pozycja 1d

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet 13, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki tylko z optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty” o objętości wypełnienia 0,3ml i wytrzymałości do 4,5 bara?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 15**

Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kraniki tylko z optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 16**

Pakiet 15-16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 17**

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem powietrza 0,1µm o wysokiej skuteczności i filtrem cząsteczkowym 5 µm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 18**

Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta?

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org





**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 19**

Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opak. a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

**Pytanie nr 20**

Pakiet 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające port nie w centralnej osi skrzydełek i wyłącznie

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

W rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]
24 x 3/4"	0,7 x 19
22 x 1"	0,9 x 25
20 x 1 1/4"	1,1 x 32
18 x 1 1/2"	1,3 x 45
17 x 1 3/4"	1,5 x 45
16 x 1 3/4"	1,7 x 45
14 x 1 3/4"	2,0 x 45 ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 21**

Pakiet 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające port nie w centralnej osi skrzydełek i wyłącznie

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- Kaniula wyposażona w skrzydełka mocujące oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego, kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 26 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardego blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

**W rozmiarach**

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]
26 x 3/4"	0,6 x 19
24 x 3/4"	0,7 x 19
22 x 1"	0,9 x 25
20 x 1 1/4"	1,1 x 32
18 x 1 1/4"	1,3 x 45
17 x 1 1/4"	1,5 x 45
16 x 1 1/4"	1,7 x 45
14 x 1 1/4"	2,0 x 45

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 22**

Pakiet 21, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające port nie w centralnej osi skrzydełek i wyłącznie

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardego blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

**W rozmiarze**

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]
24 x 3/4"	0,7 x 19
22 x 1"	0,9 x 25
20 x 1 1/4"	1,1 x 32
18 x 1 1/4"	1,3 x 45
17 x 1 1/4"	1,5 x 45
16 x 1 1/4"	1,7 x 45
14 x 1 1/4"	2,0 x 45

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 23**

Pakiet 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy posiadający:

- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 24**

Pakiet 21, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o zakresie:

regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%, bez nazwy producenta na komorze, komora wykonana z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów, bez zaworu bcv?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 25**

Pakiet 21, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający wyłącznie

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorną oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogeny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



**Zestaw pytań nr 14:**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy: Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy pakiet 26 poz.1,2 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wężyków zatwierdzonych przez producenta o wytrzymałości ciśnieniowej max 22,4 bar.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie 26 poz. 1, 2 wężyki zatwierdzone przez producenta o wytrzymałości ciśnieniowej max 22,4 bar.**

**Zestaw pytań nr 15:**

**Pytanie nr 1**

Wykonawca zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego dopuszczeni do ofertowania w pozycji 1 pakietu 36 postępowania zestawu zapewniającego pracę przez 24 godziny, składającego się z 2 osobno pakowanych wężyków pompy czasie pracy do 12 godzin oraz wytrzymałości ciśnieniowej 350 psi.

**Odpowiedź: W postępowaniu nie ma pakietu nr 36.**

**Pytanie nr 2**

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pozycji 2 pakietu 36 postępowania wężyka o wytrzymałości ciśnieniowej 350 psi.

**Odpowiedź: W postępowaniu nie ma pakietu nr 36.**

**Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowany załącznik nr 1 projektowane postanowienia umowy pod nazwą: „10.09.2024 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy”.**

**Zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 20.09.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do 18.12.2024 roku.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org